SUPERVISOR TEST

WASHINGTON CO.
SHERIFF'S OFFICE
DATAMASTER dmt: 100284

Date: 03/25/2019

OPERATOR NAME:
ROBERT J SULLIVAN
Permit #: 34106
Operator Agency/Dept: WASHINGTON CO. SO
Reference Standard #: 18360

Nominal = 0.10 g/210L

BLANK TEST	0.00	22:28
INTERNAL STANDARD	VERIFIED	22:28
REFERENCE STANDARD TEMP	34.00c	
REFERENCE STANDARD	0.10	22:28
BLANK TEST	0.00	22:29
REFERENCE STANDARD TEMP	34.00c	
REFERENCE STANDARD	0.10	22:29
BLANK TEST	0.00	22:30
REFERENCE STANDARD TEMP	34.00c	
REFERENCE STANDARD	0.10	22:30
BLANK TEST	0.00	22:31

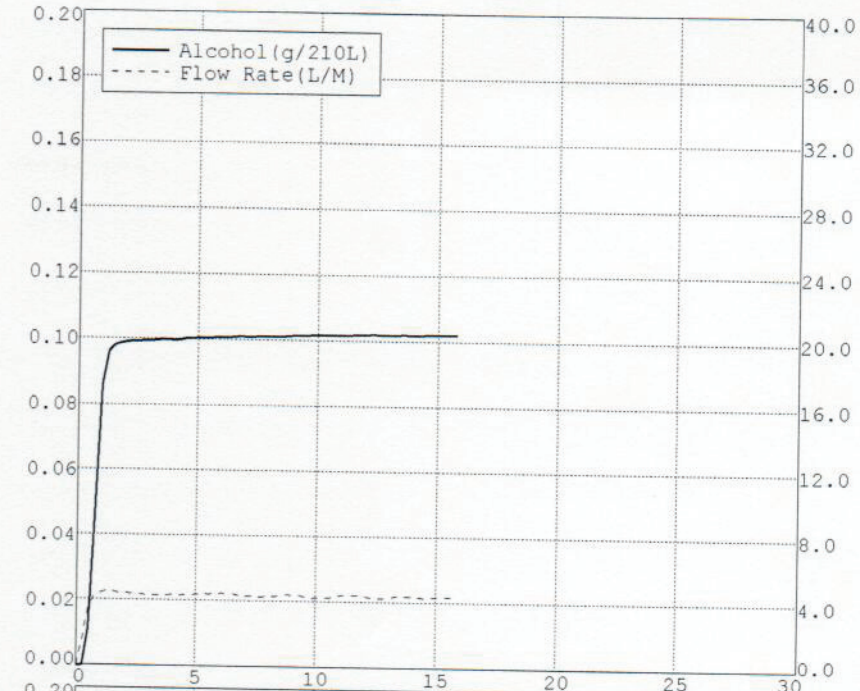

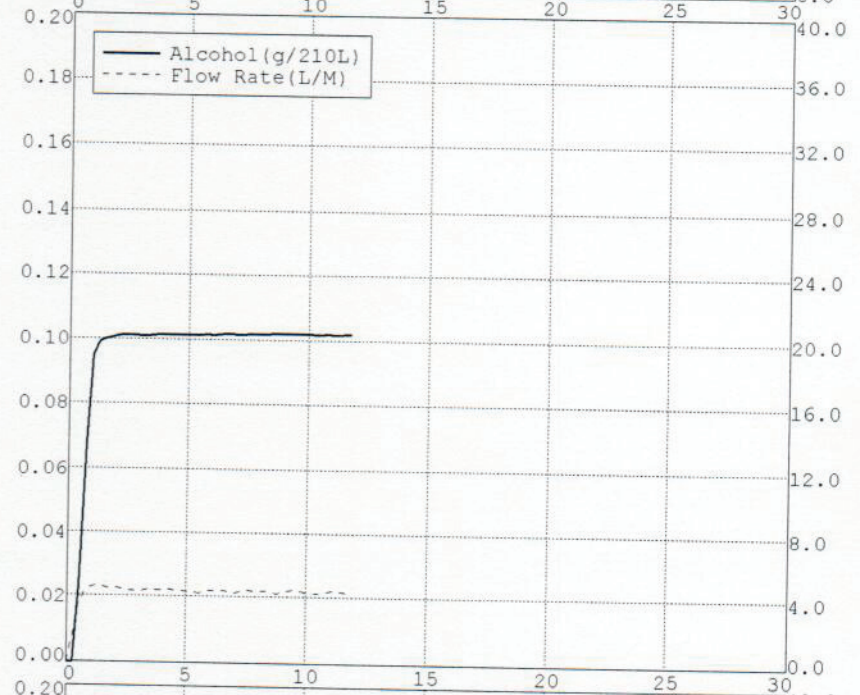

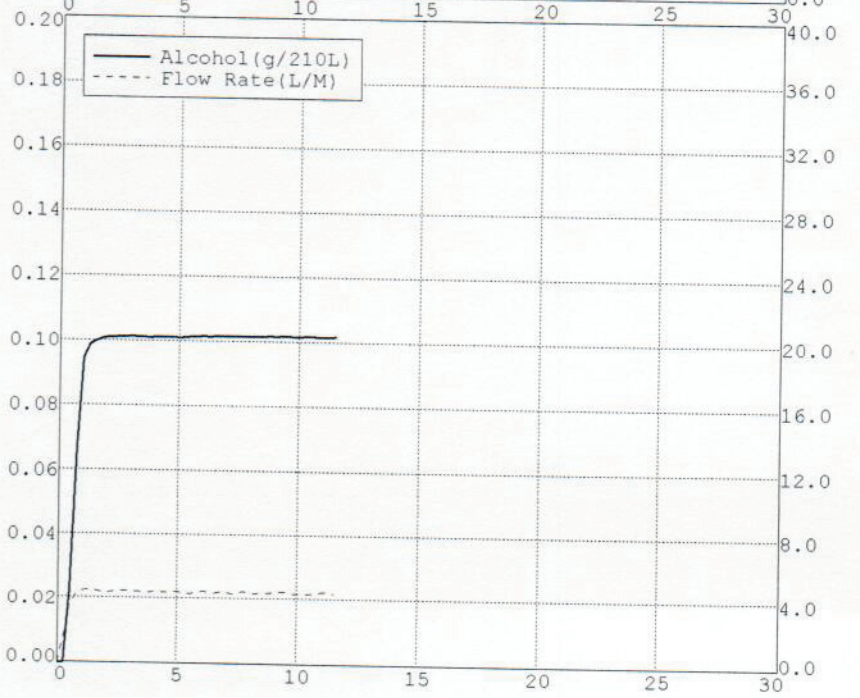

339